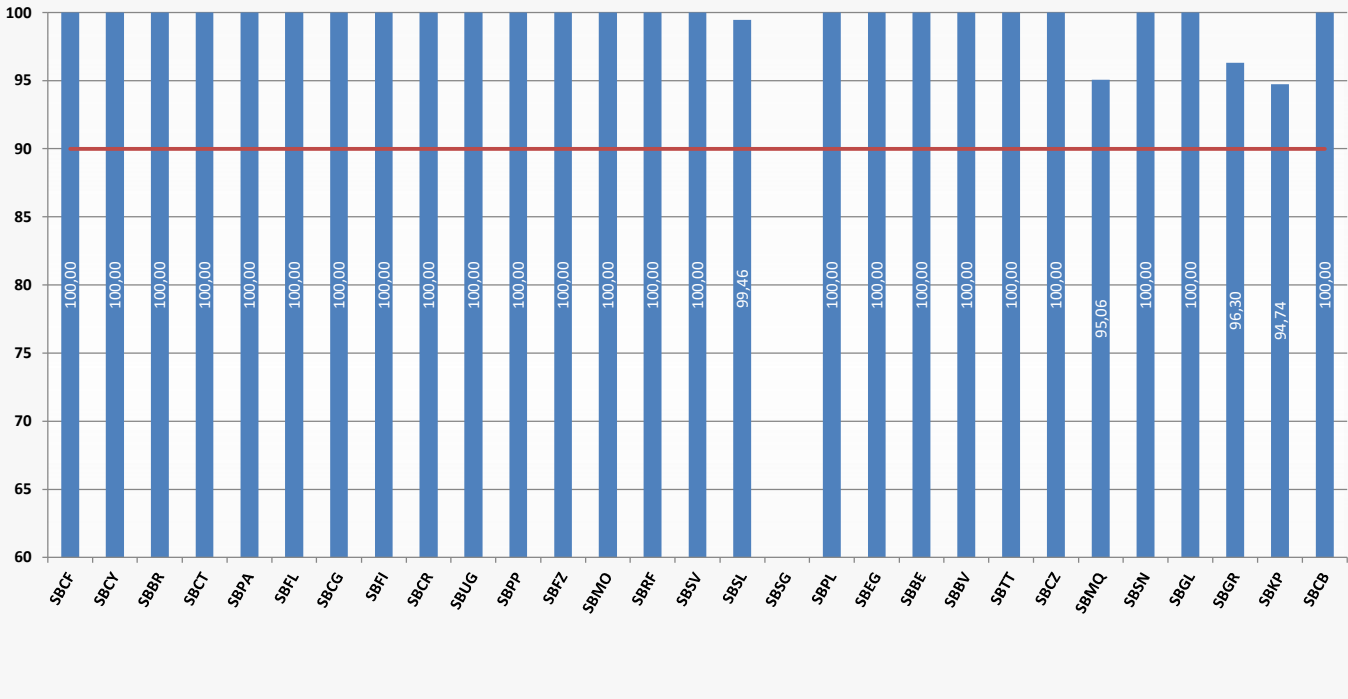
		PLANO DE METAS - 2022					Nº: I01ID																																																														
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																					
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					TIPO																																																															
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos		RESPONSÁVEL	REGIONAIS		<input type="checkbox"/>	Política da Qualidade	<input type="checkbox"/>	Objetivos da Qualidade	<input type="checkbox"/>	Processos																																																										
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																				
MEDIÇÃO	Mensal	META	90%	PRAZO	1 ano																																																																
FÓRMULA	$(\text{Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível} / \text{Quantidade de horas do mês}) \times 100$																																																																				
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																				
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO		abr/2022																																																													
DADOS DO INDICADOR																																																																					
MARÇO - 2022																																																																					
 <table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Bar Chart: MARÇO - 2022</caption> <thead> <tr> <th>Estação</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBBR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBP-A</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBF1</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBF1</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBUG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SPPP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBFZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBM0</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBRF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSL</td><td>99,46</td></tr> <tr><td>SBSG</td><td></td></tr> <tr><td>SBPL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBBE</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBBV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBT1</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBMQ</td><td>95,06</td></tr> <tr><td>SBSM</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSR</td><td>96,30</td></tr> <tr><td>SBKp</td><td>94,74</td></tr> <tr><td>SBCB</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>										Estação	ID (%)	SBCF	100,00	SBCY	100,00	SBBR	100,00	SBCI	100,00	SBP-A	100,00	SBF1	100,00	SBCG	100,00	SBF1	100,00	SBCR	100,00	SBUG	100,00	SPPP	100,00	SBFZ	100,00	SBM0	100,00	SBRF	100,00	SBSV	100,00	SBSL	99,46	SBSG		SBPL	100,00	SBSG	100,00	SBBE	100,00	SBBV	100,00	SBT1	100,00	SBCZ	100,00	SBMQ	95,06	SBSM	100,00	SBSL	100,00	SBSR	96,30	SBKp	94,74	SBCB	100,00
Estação	ID (%)																																																																				
SBCF	100,00																																																																				
SBCY	100,00																																																																				
SBBR	100,00																																																																				
SBCI	100,00																																																																				
SBP-A	100,00																																																																				
SBF1	100,00																																																																				
SBCG	100,00																																																																				
SBF1	100,00																																																																				
SBCR	100,00																																																																				
SBUG	100,00																																																																				
SPPP	100,00																																																																				
SBFZ	100,00																																																																				
SBM0	100,00																																																																				
SBRF	100,00																																																																				
SBSV	100,00																																																																				
SBSL	99,46																																																																				
SBSG																																																																					
SBPL	100,00																																																																				
SBSG	100,00																																																																				
SBBE	100,00																																																																				
SBBV	100,00																																																																				
SBT1	100,00																																																																				
SBCZ	100,00																																																																				
SBMQ	95,06																																																																				
SBSM	100,00																																																																				
SBSL	100,00																																																																				
SBSR	96,30																																																																				
SBKp	94,74																																																																				
SBCB	100,00																																																																				
ACOMPANHAMENTO																																																																					
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																																
A não divulgação do resultado do ID - referente a SBSG - ocorreu em virtude da mudança da gestão da Empresa INFRAMÉRICA para o CINDACTA III, através do DTCEA-NT.					O CINDACTA III deverá realizar as ações necessárias para a regularização do monitoramento do ID em SBSG.																																																																
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			1º Ten QOEA MET Gouvêa			VALIDAÇÃO E EMISSÃO		12/04/2022																																																													