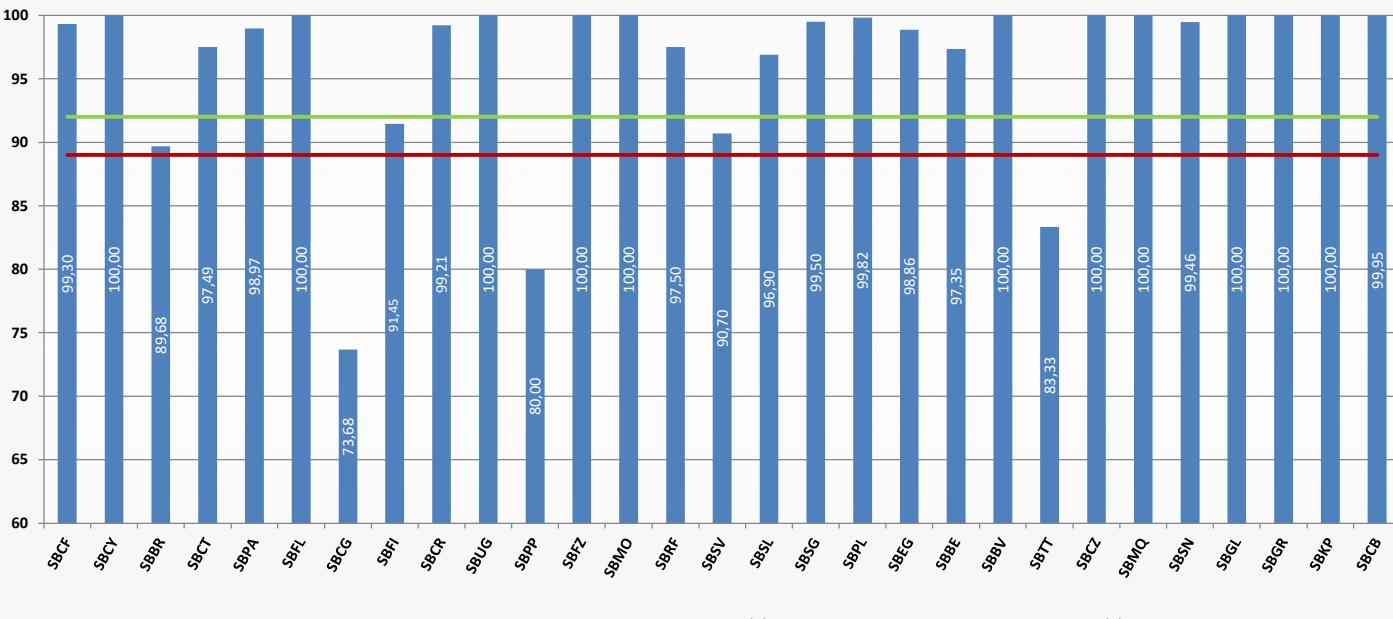


		PLANO DE METAS - 2025					Nº: I01ID				
		INFORMAÇÕES GERAIS									
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO						
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos		RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade				
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas										
MEDIDA	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano						
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100										
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível										
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há		ATUALIZAÇÃO		dez/2025				
DADOS DO INDICADOR											
OUTUBRO - 2025											
											
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: $89\% \leq ID < 92\%$, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.									
ACOMPANHAMENTO											
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS							
<p>Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de OUT 2025: 1) O DTCEA-CG ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET e OUT 2025; 2) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET e OUT 2025; 3) O DTCEA-TT ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET e OUT 2025; 4) O DTCEA-FI ficou abaixo do LIT (89%) no mês de SET 2025 e abaixo da meta (92%) no mês de OUT 2025; 5) O DTCEA-BR ficou abaixo da META (92%) no mês de OUT 2025; e 6) O DTCEA-SV ficou abaixo da META (92%) no mês de OUT 2025.</p>				O DTCEA-CG, o DTCEA-FI, o DNB-PP e o DTCEA-TT já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.							
ELARORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO					
				28/11/2025							